




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 51/24

Poznań, dnia 05.11.2024 r.

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na Dostawa drobnego sprzętu medycznego (typu: elektrody, akcesoria stomijne, odzież medyczna wielorazowa itp.)-9 pakietów

I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej :

1. SWZ część Cześć I – Informacje Ogólne Rozdział VI - Okres obowiązywania umowy i termin wykonania zamówienia zmiana polega na wydłużeniu terminu dostawy dla Pakietów nr 8 i 9 do 15 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego zmiany zaznaczone pogrubiona czcionką

Jest:

Rozdział VI - Okres obowiązywania umowy i termin wykonania zamówienia

1. Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie strony przez **okres 24 miesięcy**
2. Termin dostawy do 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego
Termin dostawy dla Pakietu nr 3 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego

Po zmianach :

Rozdział VI - Okres obowiązywania umowy i termin wykonania zamówienia

1. Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie strony przez **okres 24 miesięcy**
2. Termin dostawy do 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego
Termin dostawy dla Pakietu nr 3 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego
Termin dostawy dla Pakietów nr 8 i 9 do 15 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego

2. SWZ załącznik nr 7 „Projekt umowy” w §2 ust. 3 zmiana polega dopisaniu słów o brzmieniu **Termin dostawy dla Pakietów nr 8 i 9 do 15 dni roboczych** od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego zmiany zaznaczone pogrubiona czcionką

Po zmianach :

§2

Realizacja Przedmiotu umowy – warunki i terminy dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar najwyższej jakości.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia Zamawiającego, który określi każdorazowo asortyment i wielkość dostawy. Zamówienia będą składane pisemnej lub elektronicznie na wskazany adres poczty elektronicznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na adres siedziby Zamawiającego, bezpośrednio do pomieszczeń magazynowych (wysokość wjazdu : 3,5 m) /pralni w godz. 8:00 - 13:30 w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego. Termin dostawy dla Pakietu nr 3 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego . **Termin dostawy dla Pakietów nr 8 i 9 do 15 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zamówienia** od Zamawiającego Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy (niedziele i święta) lub poza godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar transportem na własne ryzyko. Koszt transportu zawarty jest w cenie umowy.
5. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy do chwili potwierdzenia odbioru dostawy przez Zamawiającego.

II. Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 5 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody prostokątnej o wymiarach 44 mm x 30mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 5 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody okrągłej z wypustką o średnicy 45mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy §5 ust. 1d

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zmiana umowy wymaga zgody każdej ze stron.

Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy § 6 ust. 2

Prosimy o możliwość złożenia dokumentów, o których mowa w par. 6 ust. 1 wraz z ofertą bądź łącznie z podpisywaną umową.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 4

Ad1,2. Czy Zamawiający, będzie wymagał, by zaoferowane elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 4

Ad1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, wykonanych ze srebra/chlorku srebra dla uzyskania wysokiej jakości i skuteczności klinicznej oraz komfortu pacjenta. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 4

Ad1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, odpornych do min.50 kolejnych obciążeń defibrylacji (w przypadku elektrod dla pacjentów dorosłych). Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora..

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 4

Ad1. Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz zgodnych z wytycznymi Stowarzyszenia AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) zalecających stosowanie odpowiednich elektrod, przy założeniu optymalnej wielkości elektrod do defibrylacji 12 cm².

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o wytrzymałości po starzeniu min.6N, pozostałe zgodne?.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia 21 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt. 1 i 2

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza bluzy damskie i męskie wkładane przez głowę w serek (bez dodatkowego zakładu)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści linię próbkującą o długości 2,5 m w miejsce wymaganej długości 2m (+/- 20cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 13

Prosimy o zmianę terminu dostaw częściowych. Przygotowanie produkcji , zakup tkaniny, szycie oraz skompletowanie i sama dostawa np. kurierem nie trwają 3 dni , zazwyczaj około 14 dni roboczych. Umieszczenie tak krótkiego terminu realizacji sugeruje zlecenie zamówienia firmie posiadającej w magazynie wymaganą odzież.

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt. 1 i 2

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 9

Prosimy o dopuszczenie ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku wykonanych z chłonnej, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego 1,4 % i zawartości bawełny 54,6 %, o gramaturze 125 +/- 6 g/m², średniej przepuszczalności powietrza powyżej 50 cm³/cm²/s, zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:

- pylenia
- czystości pod względem cząstek stałych
- parametrów wytrzymałościowych (wytrzymałości na wypychanie na sucho, wytrzymałość na rozciąganie na sucho)

Tkanina ta została dopuszczona do produkcji ubrań chirurgicznych przez Komisję ds. Wyrobów Medycznych przy Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Dzięki w.w. właściwością zapewnia ona komfort cieplny użytkownikom spełniając jednocześnie wymagania Zamawiającego dotyczące cykli prania i sterylizacji..

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłożenie Certyfikatu GOTS

GOTS, czyli **Global Organic Textile Standard** to wiodący na świecie standard certyfikujący wyroby tekstylne. Certyfikat GOTS obejmuje wszystkie etapy produkcji wyrobów z tkanin , jako dokument równoważny dla certyfikatu „ Przyjazny dla człowieka” ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 8

Prosimy o dopuszczenie tkaniny elanobawełnianej o składzie 50% bawełny i 50% poliestru i gramaturze 170g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 8


W opisie produktów w załączniku 1-6 pojawiły się rozbieżności między opisem a rysunkami, które jest wiążące?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia ,że opis jest wiążący rysunki w celu poglądowym tj. umieszczenie kieszeni i krój .

Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 8

Prosimy o dopuszczenie innego rozwiązania karczku i dekoltu w bluzach :

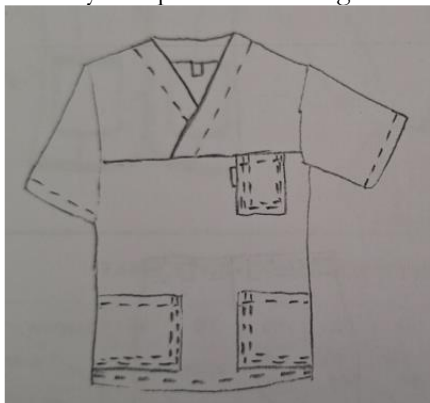

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 7 poz.1

Czy zamawiający dopuści linie próbkującą do monitoringu gazów oddechowych o długości 2,5 m (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza kitle damskie i męskie (poz. 2 i 3) z kołnierzykiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści odzież z tkaniny bawełniano - poliestrowej o zawartości bawełny min. 48% i gramaturze 150 – 170 g/m²?

Proponowana tkanina gwarantuje wysoki komfort termofizjologiczny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści kroje odzieży w pakiecie 8 jak poniżej:

- Bluza damska- krótki rękaw, 3 kieszenie (2 dolne, 1 na lewej piersi), wkładane przez głowę, dekolt w serek, kieszonka górna z organizerem; taliowania zaszewkami z przodu i z tytułu, rozcięcia boczne ułatwiające ruchy;
- Kitle (fartuchy) damskie- z kołnierzem, zapinany na napy, z długim lub krótkim rękawem, z zaszewkami, taliowany. Kieszenie boczne naszywane na wysokości bioder, górna na wysokości serca;
- Bluzy męskie – krótki rękaw, 3 kieszenie (2 dolne, 1 na lewej piersi), wkładane przez głowę, dekolt w serek, kieszonka górna z organizerem; taliowania zaszewkami z tytułu;
- Spodnie męskie – nogawki proste, dwie kieszenie boczne, wpuszczone; na gumę i zamek;
- Kitle (fartuchy) męskie- z kołnierzem, zapinany na napy, z długim lub krótkim rękawem, prosty. Kieszenie boczne naszywane na wysokości bioder, górna na wysokości serca?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie haftem bluz i kitli po prawej stronie bluzy, na wysokości kieszonki piersiowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odzieży minimum w 4 kolorach: niebieskim, granatowym, różowym, białym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 25 dot. Pakietu nr 8

Zamawiający wymaga zgodności odzieży z normą PN-P 84525:1998 i PN-EN ISO 13688:2013-2012. Normy te stosowane są dla odzieży roboczej, określając wymogi materiału oraz dodatków. Normą określającą wymogi dla odzieży stosowanej w placówkach opieki zdrowotnej jest norma CEN/TS 14237.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności odzieży z normami PN-P 84525:1998 i PN-EN ISO 13688:2013-2012, pozostając przy wymogu zgodności z normą CEN/TS 14237?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 26 dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu Znak Ekologiczny „Przyjazny dla Człowieka”, w miejsce którego będzie wymagał Certyfikatu Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę, zamki, nici i napy zastosowane w produkcji odzieży?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 27 dot. Pakietu nr 8

Czy aby otrzymać odzież najwyższej jakości, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą Certyfikatu na wyrób gotowy potwierdzający zgodność z normą CEN/TS 14237 Tabela 9 wystawionego przez niezależne laboratorium badawcze?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 28 dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający odstąpi od pakowania odzieży jednostkowo, w foliowe worki z opisem rozmiaru odzieży, dopuszczając pakowanie zbiorczo w jeden worek umieszczony w karton tego samego rodzaju asortymentu, tj. w tym samym kolorze i rozmiarze, a karton opisany asortymentem?

Pakowanie osobno każdej sztuki wyrobu jest nieekologicznie i generuje bardzo dużą ilość odpadów. Poza tym, każdy wyrób przed pierwszym użyciem należy wyprać, więc pakowanie pojedyncze nie ma żadnego uzasadnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 29 dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie odzieży operacyjnej estetycznym, trwałym, niespialnym termodrukiem o wysokości liter 0,6cm z nazwą szpitala i/lub oddziału zamiast haftu?

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o dopuszczenie haftu po prawej stronie, na wysokości kieszonki piersiowej. Haft znacznie podraża ofertę na odzież oraz wydłuża czas realizacji zamówień.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 30 dot. Pakietu nr 9

Zamawiający wymaga zgodności odzieży operacyjnej z normą PN-EN 13759. Czy aby mieć potwierdzenie zgodności oraz aby otrzymać odzież chirurgiczną (bluzy, spodnie, sukienki) najwyższej jakości, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty akredytowanego raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającego skład chemiczny tkaniny oraz gramaturę tkaniny oraz akredytowanego raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 13795 dla tkaniny wskazanej w badaniach potwierdzających skład i gramaturę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 31 dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dla pakietu 8 i 9 na 14 dni roboczych?

Zamawiający określił termin dostawy do 5 dni roboczych, wykonawcy każdorazowo odszywają odzież zgodnie ze specyfikacją rozmiarową i kolorystyczną określoną w zamówieniu jednostkowym.

Oznakowanie odzieży również wydłuża realizację zamówień.

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt. 1 i 2

Pytanie nr 32 dot. Pakietu nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 33 dot. Pakietu nr 5 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 34 dot. Pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby otwór dozujący dyspensera rękawic diagnostycznych posiadał dodatkową folię chroniącą zawartość przed kontaminacją?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 35 dot. Pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 36 dot. Pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby rękawice były pakowane automatycznie w sposób naprzemienny (każda sztuka) płasko warstwami (rękawice układane jedna po drugiej w przeciwnym kierunku - palce – mankiet) co zapewnia pobieranie za każdym razem pojedynczych rękawic chwytyanych zawsze w obszarze dłoni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

.....
Dyrektor Szpitala

Opracowała : Beata Zoellner

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACIENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem